

压缩空气采集器操作规程

1、检测方法标准：《压缩空气：颗粒含量》-2019

2、检测仪器：GC101


3、检测步骤：

3.1 将 O 型圈固定在过滤器连接件上，然后将排气过滤器压紧。

3.2 选择合适的流量控制阀，将气管与之连接。

3.3 针对不同的机型选择不同的管道适配器与主机连接。

3.4 通压缩空气，进行检测。

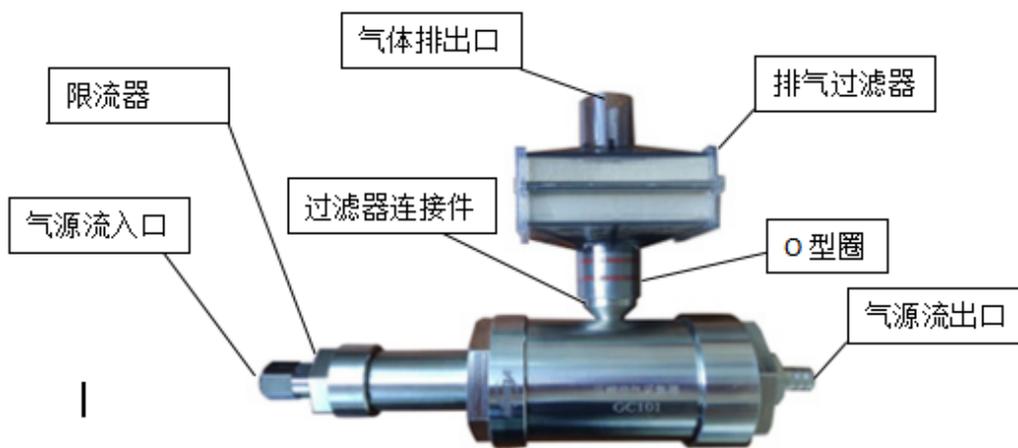

GC101 和尘埃粒子计数器连接图



GC101 和浮游菌采样器连接图

